


Sinus Lift Instruments
Instruments à Sinus
Instrumentos sinusales
Strumentario per il rialzo del seno

Sinus Lift Instrumente

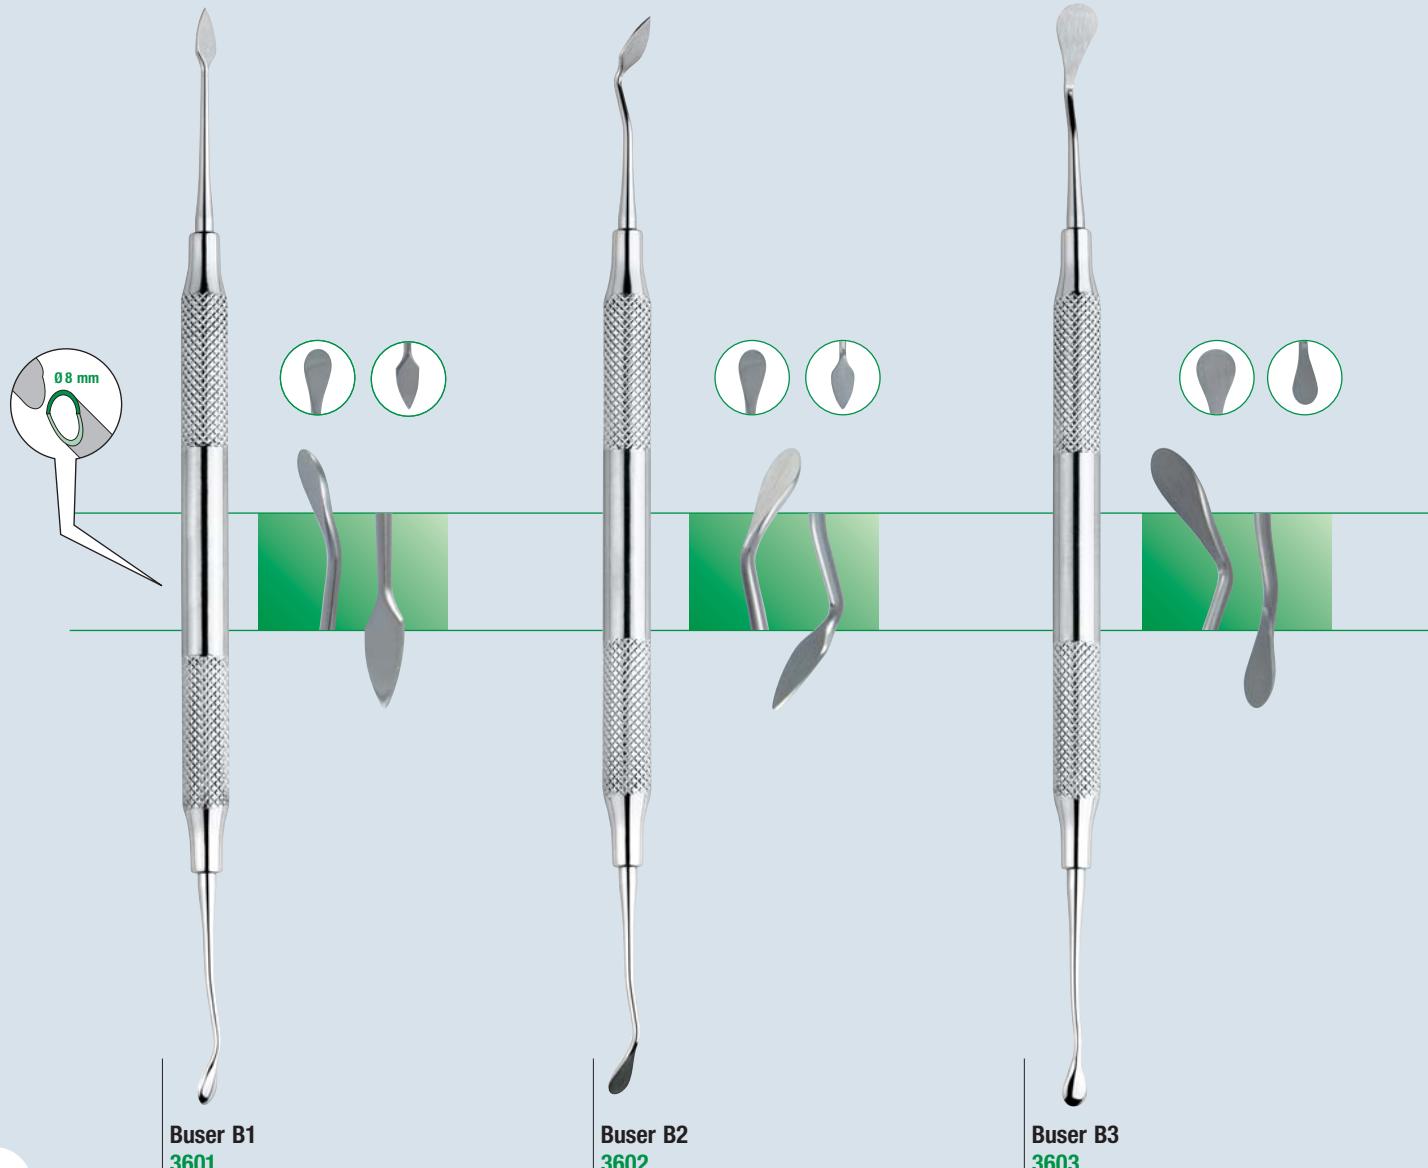

Buser B1/B2/B3
3601/3602/3603


Raspatorien
periosteal elevators
décolleurs
periostotomos
periostotomi



Foto = Dr. Bernard Guillaume

Sinus Lift Instrumente

Sinus Lift Instruments
Instruments à Sinus
Instrumentos sinusales
Strumentario per il rialzo del seno

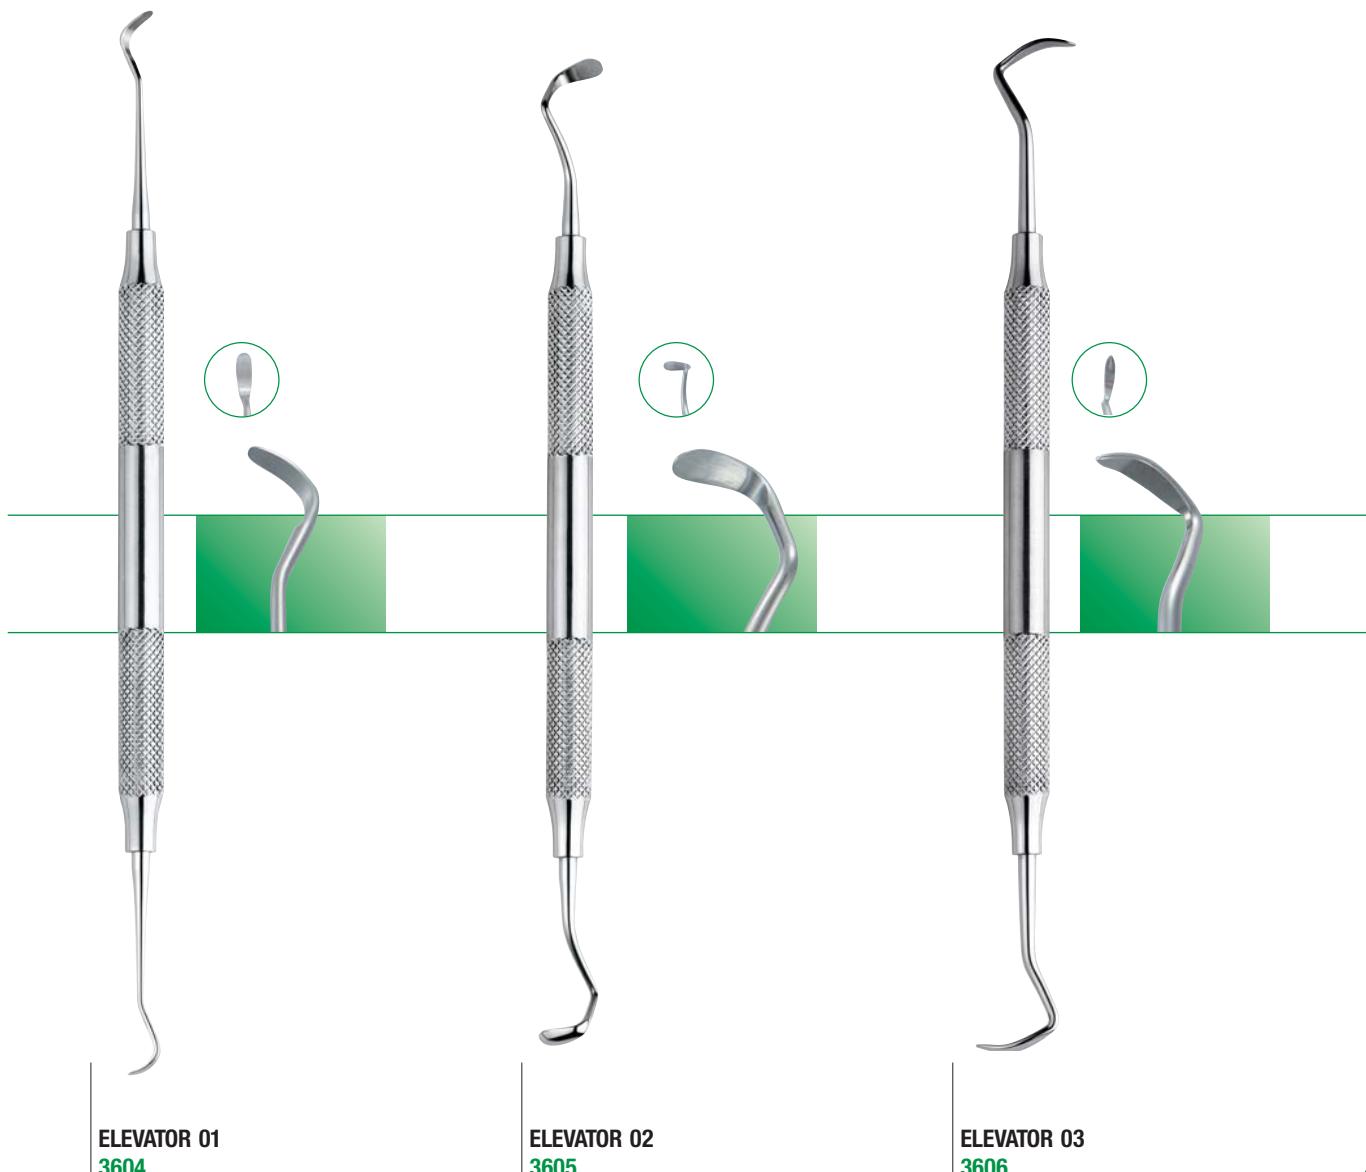

Fotos = Dr. Bernard Guillaume

ELEVATOR 01/02/03
3604/3605/3606

Sinusboden-Elevatoren, stumpf, zum sanften Ablösen und Anheben der Schneider'schen Membran.

Sinus floor elevators, blunt, for gently releasing and raising the Schneiderian membrane.

Élèvateurs de plancher sinusal, mousses, pour le décollement et le soulèvement tout en douceur de la membrane de Schneider

Elevadores del suelo del seno sin filos, para un desprendimiento y levantamiento suaves de la membrana de Schneider

Elevatori per il rialzo del seno mascellare, spuntati, per scollare e sollevare delicatamente la membrana di Schneider.


Sinus Lift Instruments

Instruments à Sinus

Instrumentos sinusales

Strumentario per il rialzo del seno

Sinus Lift Instrumente

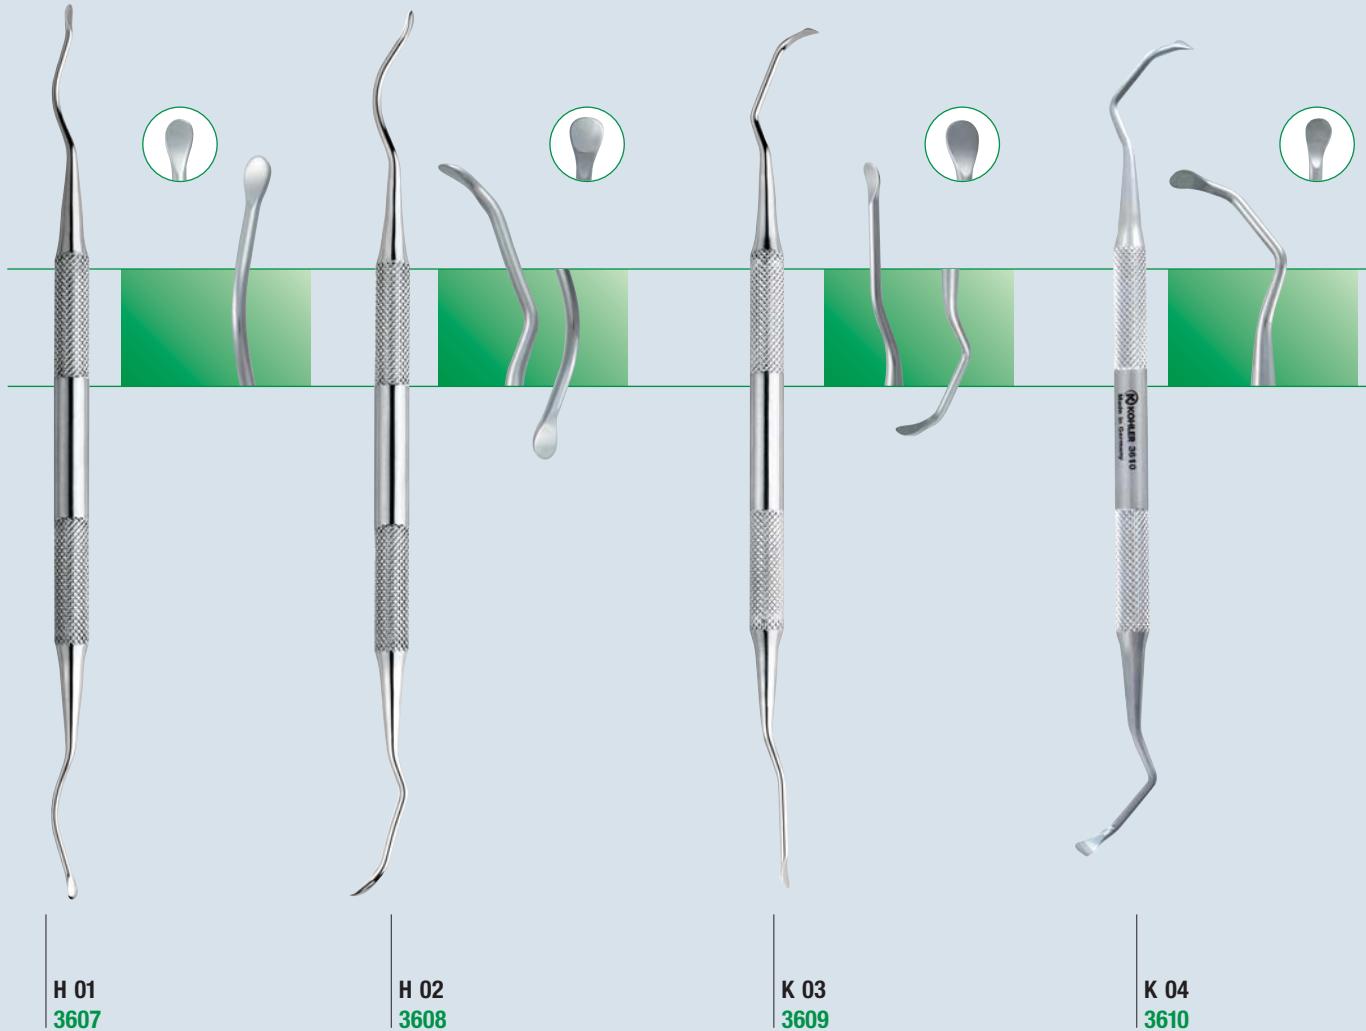

H 01/H 02/K 03
3607/3608/3609



Fotos = Dr. Bernard Guillaume

64

Sinusboden-Elevatoren, stumpf: zum Ablösen und sanften Schieben der Schneider'schen Membran nach kranial.

Sinus floor elevators, blunt, for releasing and gently pushing the Schneiderian membrane cranially.

Élevateurs de plancher sinusal, mousses, pour le décollement et le soulèvement tout en douceur de la membrane de Schneider en direction crânienne.

Elevadores del suelo del seno sin filos, para el desprendimiento y deslizamiento suave de la membrana de Schneider hacia craneal

Elevatori per il rialzo del seno mascellare, spuntati: per scollare e spingere la membrana di Schneider delicatamente in direzione craniale.

Sinusboden-Elevatoren, stark gekrümmt: für die tiefe Anhebung der Membran vom Boden der Sinuskavität.

Sinus floor elevators, tightly curved, for raising the deep area of the membrane from the floor of the sinus cavity.


Élevateurs de plancher sinusal, fortement coudés : Pour le décollement de la membrane à partir de la profondeur du plancher de la cavité sinusal.

Elevadores del suelo del seno con una curvatura muy pronunciada, para la elevación profunda de la membrana del suelo de la cavidad sinusal.

Elevatori per il rialzo del seno mascellare, fortemente angolati: per sollevare la membrana di Schneider in profondità dal pavimento della cavità sinusal.


Sinus Lift Instrumente

Sinus Lift Instruments
Instruments à Sinus
Instrumentos sinusales
Strumentario per il rialzo del seno

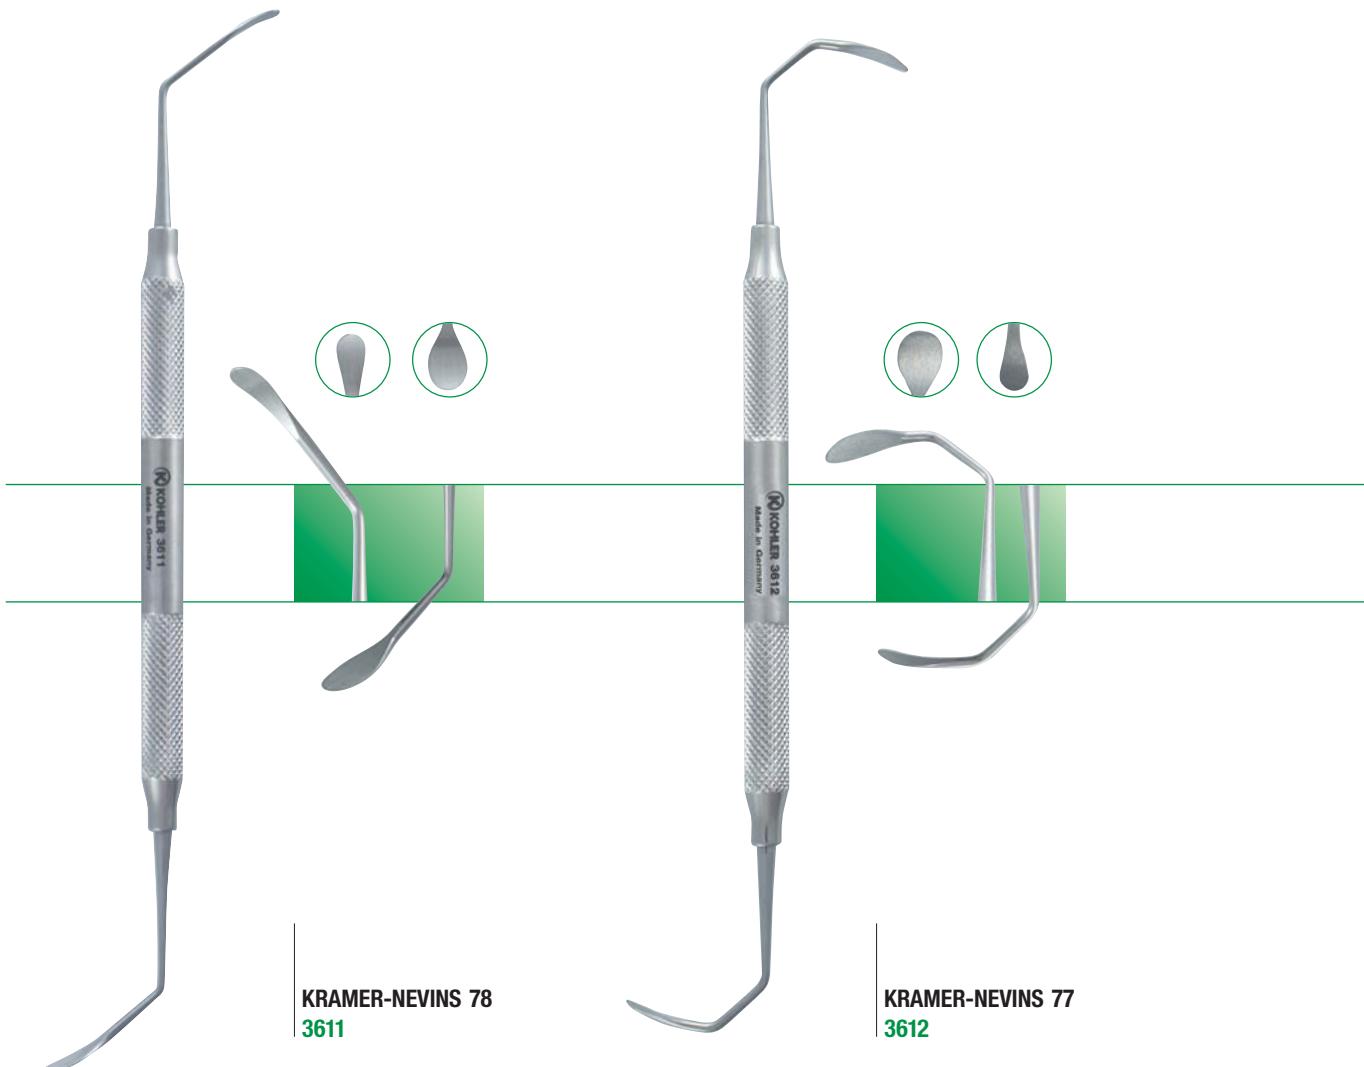

KRAMER-NEVINS 78
3611

KRAMER-NEVINS 77
3612

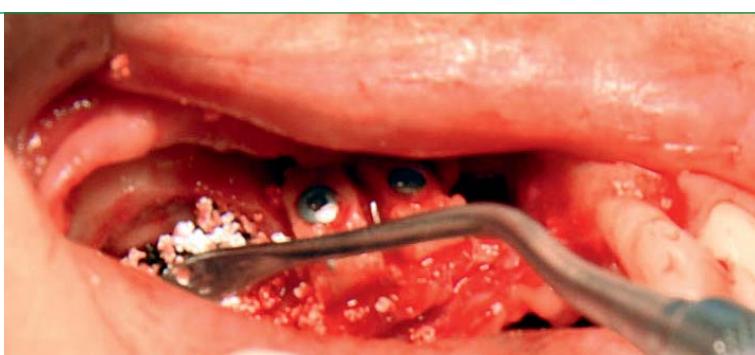

Fotos = Dr. Bernard Guillaume

KRAMER-NEVINS 77/78
3611/3612

Sinusboden-Elevatoren, stark gekrümmt: für die tiefe Anhebung der Membran vom Boden der Sinuskavität.

Sinus floor elevators, tightly curved, for raising the deep area of the membrane from the floor of the sinus cavity.

Elévateurs de plancher sinusal, fortement coudés : Pour le décollement de la membrane à partir de la profondeur du plancher de la cavité sinuse.

Elevadores del suelo del seno con una curvatura muy pronunciada, para la elevación profunda de la membrana del suelo de la cavidad sinusal.

Elevatori per il rialzo del seno mascellare, fortemente angolati: per sollevare la membrana di Schneider in profondità dal pavimento della cavità sinusale.

Sinus Lift Instruments, flexible Instruments à Sinus, flexible Instrumentos sinusales, flexibles Strumentario per il rialzo del seno, flessibile

Sinus Lift Instrumente, flexibel


Flexible Sinus Lift Instrumente erhöhen das operative Feingefühl und reduzieren die Perforationsgefahr der „Schneider'schen Membrane“.

Flexible sinus lift instruments increase the sensitiveness during operation and reduce the risk of perforating the sinus membrane.

Instruments à sinus flexibles augmentent la sensitivité pendant l'opération et diminuent le risque de perforer la membrane de sinus.

Instrumentos sinusales flexibles aumentan la sensitividad durante la operación y reducen el riesgo de perforar la membrana natural del seno Schneider.

Strumentario per il rialzo del seno, flessibile aumentano la sensibilità durante l'operazione e per ridurre il rischio di perforazioni della membrana del seno.

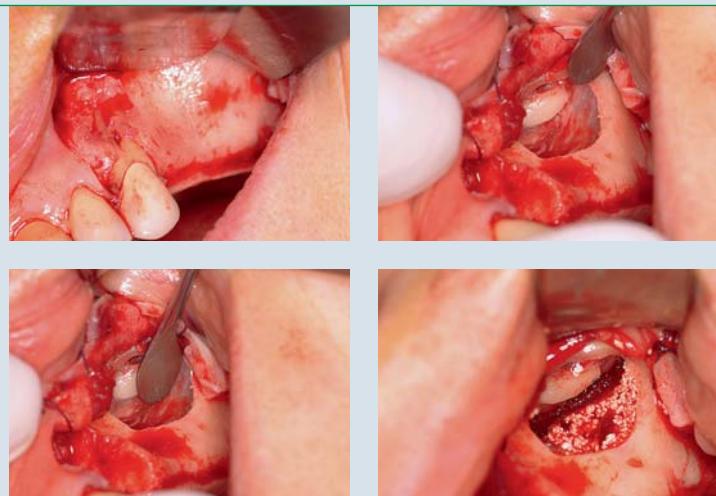

Fotos = Dr. Bernard Guillaume

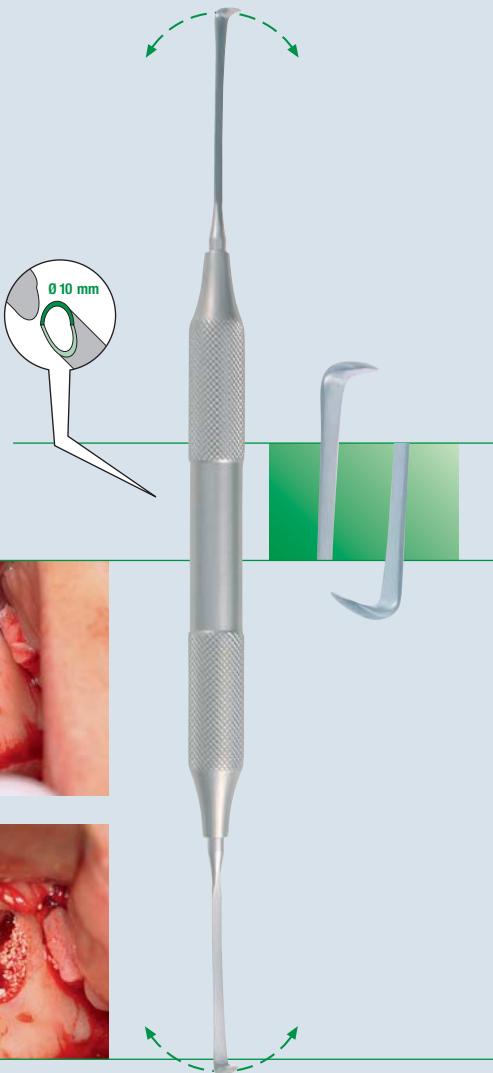


Fig. 1
7373

Ein Arbeitsende ist schwach gewinkelt, das andere stark gewinkelt. Mit dem Instrument Fig. 1 beginnt das Ablösen der Schneider'schen Membran.

One working end is curved gently and the other is curved tightly. The instrument shown in Fig. 1 is used to begin releasing the Schneiderian membrane.

Une extrémité travaillante est faiblement coudée, l'autre l'est fortement. À l'aide de cet instrument est débuté le décollement de la membrane de Schneider.

Una parte activa tiene una ligera angulación y la otra tiene una angulación muy pronunciada. Con este instrumento comienza el desprendimiento de la membrana de Schneider.

Una delle parti attive dello strumento è leggermente angolata, l'altra invece presenta una forte angolazione. Con questo strumento viene iniziato lo scollamento della membrana di Schneider.

Sinus Lift Instrumente, flexibel

Sinus Lift Instruments, flexible
Instruments à Sinus, flexible
Instrumentos sinusales, flexibles
Strumentario per il rialzo del seno, flessibile



Fig. 2
7374

Ein Arbeitsende ist schwach gewinkelt, das andere stark gewinkelt. Die Fig. 2 dient dem Ablösen der Membran nach krestal-mesial und distal.

One working end is curved gently and the other is curved tightly. The instrument shown in Fig. 2 is used to begin releasing the membrane crestally-mesially and distally.

Une extrémité travaillante est faiblement coudée, l'autre l'est fortement. Le modèle de la figure 2 convient pour le décollement en direction de la crête, dans les sens mésial et distal.

Una parte activa tiene una ligera angulación y la otra tiene una angulación muy pronunciada. El instrumento que se muestra en la Fig. 2 sirve para realizar el desprendimiento de la membrana hacia crestal-mesial y distal.

Una delle parti attive dello strumento è leggermente angolata, l'altra invece presenta una forte angolazione. Lo strumento illustrato in Fig. 2 viene utilizzato per scollare la membrana in direzione mesio crestale e distale.



Fig. 3
7375

Ein Arbeitsende ist gewinkelt, das andere gerade. Die Fig. 3 eignet sich für den palatalen Lift.

One working end is angled and the other is straight. The instrument shown in Fig. 3 is used for palatal lifts.

Une extrémité travaillante est coudée, l'autre est droite. Le modèle de la figure 3 convient pour le lift palatin.

Una parte activa es angulada, la otra es recta. El instrumento que se muestra en la Fig. 3 es adecuado para una elevación palatina.

Una delle parti attive dello strumento è angolata, l'altra invece è diritta. Lo strumento illustrato in Fig. 3 è previsto per il rialzo palatale.